



ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению изделия
нормализации серотонинового баланса организма
Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластырь (НМР)
“SCHALI® – Адъювантная онкотерапия”

NANO
SCHALIPRODUCT
LASER

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению изделия нормализации серотонинового баланса организма Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластырь (НМП) "SCHALI® – Адьювантная онкотерапия"

СОСТАВ:

НМП SCHALI®-Адьювантная онкотерапия - гидроколлоидный минеральный пластырь на основе активной композиции SCHALI® (двуокись титана (TiO₂) SCHALI®-T/10-S).

Двуокись титана, альгинат кальция, диоктиладипинат, эластомер, карбоксиметилцеллюлоза натрия, 100% гидрогенизированный полимер, полиуретановая пленка.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии НМП SCHALI® обеспечивает достижение сбалансированного уровня серотонина в организме человека.

Синергический эффект взаимодействия гидроколлоидного минерального пластыря серии НМП SCHALI® способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов в организме человека. В момент соприкосновения изделия с кожей возникает тепловая реакция, в результате которой на поверхности насыщенных энергетическими реактогенными центрами кристаллов особого класса оксидов (TiO₂), являющихся полупроводниками, вырабатываются активные молекулы кислорода [O₂(a¹Δ_g)]. Проявление активности кислорода способствует возникновению энергии и, соответственно, переносу этой энергии на определенные участки тела. В результате этого запускается и поддерживается каскад биорезонансных волновых процессов. Это способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов, регулированию ингибирования обратного захвата серотонина путём избирательного блокирования всасывания серотонина мембраной пресинаптической клетки. Вследствие устранения дисбаланса нейромедиатора в синаптической щели усиливается нейротрансмиссия в серотонинергических синапсах.

Обеспечение сбалансированного уровня серотонина в организме оказывает выраженный положительный эффект на состояние здоровья человека и способствует устранению симптомов различных патологических состояний, восстановлению автоматизма и сократительной функции гладкой мускулатуры; агрегации тромбоцитов; подвижности нейтрофилов.

Здоровое функционирование рецепторов серотонина - одного из важнейших нейротрансмиттеров в организме - также помогает нормализовать восприятие болевых ощущений и способствует улучшению общего психоэмоционального состояния человека.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Изделие может использоваться при проведении курсов адьювантной противораковой терапии (все типы системной, радио-лучевой и химиотерапии) для облегчения переносимости противораковой терапии организмом и облегчения протекания ее возможных побочных действий.

- Боли, обусловленные опухолью:
- Инфильтрация костей и мягких тканей
- Сдавливание и инфильтрация нервов, кровеносных и лимфатических сосудов
- Опухолевые некрозы на слизистой с инфильтрацией и перфорацией
- Формирование отека мозга
- Паранеопластический синдром
- Герпетическая невралгия
- Венозные тромбозы, пролежни
- Грибковые инфекции.

- Боли, обусловленные противоопухолевым лечением:
- Боли, обусловленные операцией: повреждение нерва, рубцевание, отек, перерастяжение мышц
- Боли, обусловленные ЛТ: фиброзы, нейропатия, лучевой остеомиелит, мукозиты
- Боли, обусловленные ХТ: воспаление, паравазации, мукозиты, нейропатия
- Нарушения, обусловленные самой противоболевой терапией: запоры, непроходимость при применении опиоидов
- Сопутствующие боли: мигрень, спастические боли, артриты.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Изделие может быть использовано в составе комплексной терапии, совместимо с лекарственными препаратами.

При использовании изделия коррекция дозировки назначенных лекарственных средств или их отмена производится лечащим врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изделие следует наклеить на шею сзади в область 7-го (наиболее выступающего) шейного позвонка и на акупунктурные точки (см. Схему акупунктурных точек), а также на проблемные участки болевых ощущений или дискомфорта над внутренними органами и носить его непрерывно, не снимая даже в ночное время. Изделие устойчиво к воздействию воды и перепаду температур, может использоваться в среднем 3–7 дней. Появление чувства тепла в области воздействия изделия является нормальной реакцией и не требует прекращения использования. Первый эффект можно почувствовать - в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека - спустя 10-40 минут. Курс применения изделия определяется в каждом случае индивидуально.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Фиксирующая часть изделия состоит из полимерного экоблагоприятного материала прозрачного цвета с гипоаллергенным клеевым покрытием и входящей в гидроколлоидную основу активной минеральной композиции SCHALI®. Изделие с двух сторон покрыто защитными внутренними лепестками. Изделие стерильно и выпускается в индивидуальной контурной упаковке с контролем вскрытия.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Изделие следует хранить в неповрежденной контурной упаковке при температуре не выше +25°C, без соприкосновения с пахнущими и химическими веществами.

Не допускается ношение изделия в сауне и солярии.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

При приеме солнечных ванн изделие не использовать.



СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности изделия составляет 3 года с даты производства.

Не рекомендуется использовать изделие после срока годности, указанного на упаковке.

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии **HMP SCHALI®** производится по лицензии
No. 286-S

Схема акупунктурных точек

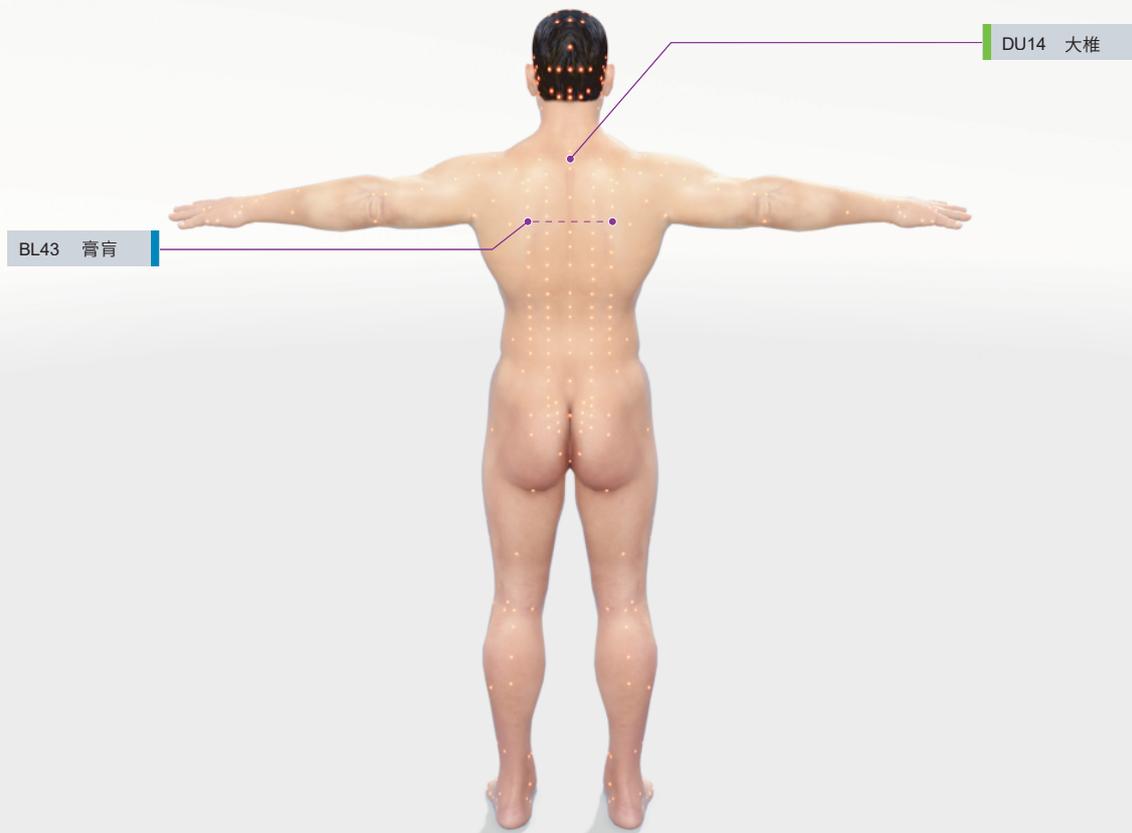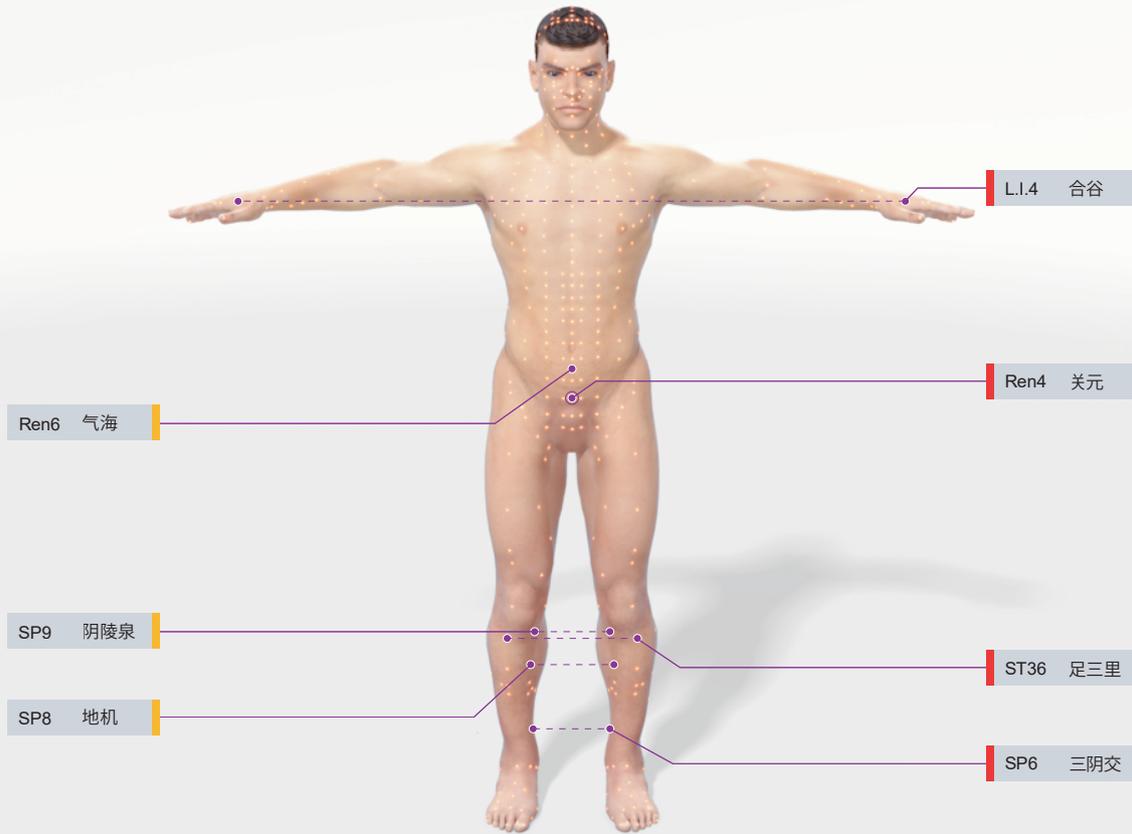

Методика акупунктурной терапии соответствует Стандартной Акупунктурной Номенклатуре (ВОЗ 1993 г.).

С более подробной информацией о методике акупунктурной терапии можете ознакомиться на сайте www.schalipharma.com



SCHALIPRODUCT
NANO
LASER

NANO
LASER
SCHALIPRODUCT

NANO
LASER
SCHALIPRODUCT

NANO
LASER
SCHALIPRODUCT

1

NANO
LASER
SCHALIPRODUCT

NANO
LASER
SCHALIPRODUCT