




ИНСТРУКЦИЯ
 по медицинскому применению изделия
 нормализации серотонинового баланса организма
 Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластырь (НМР)
“SCHALI® - ЭМИ (электромагнитное излучение)“

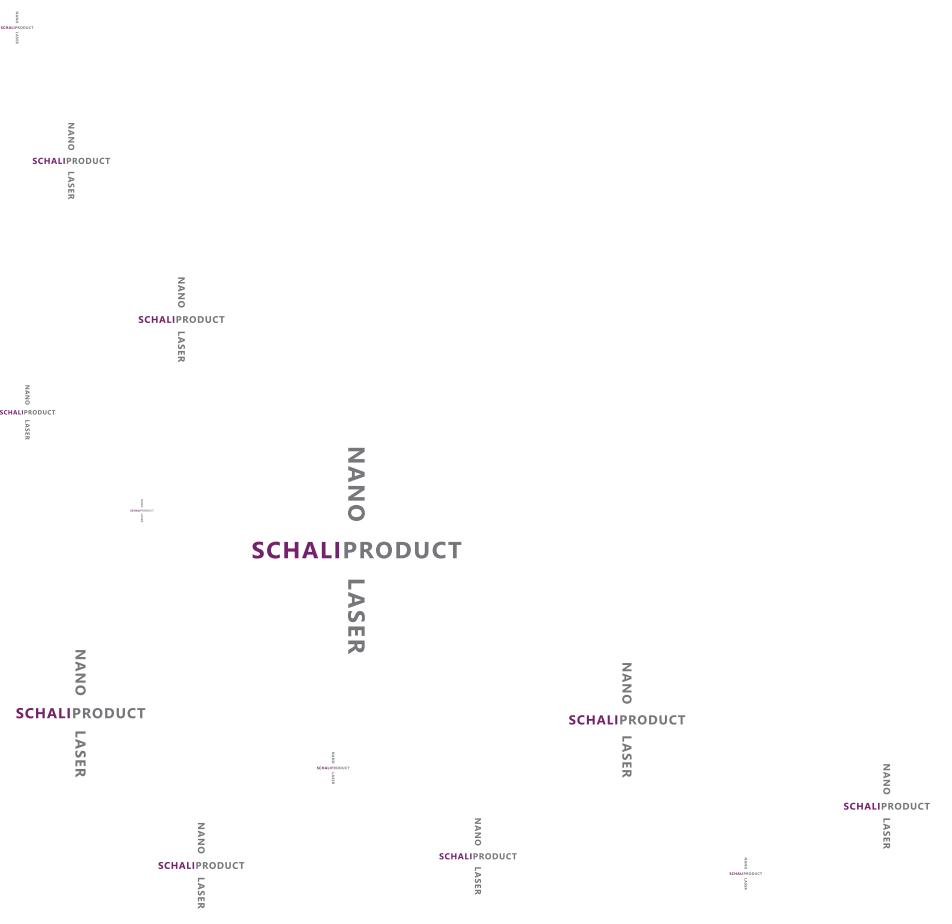

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению изделия нормализации серотонинового баланса организма **Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластирь (HMP) “SCHALI® - ЭМИ (электромагнитное излучение)”**

СОСТАВ:

HMP SCHALI® - ЭМИ - гидроколлоидный минеральный пластырь на основе активной композиции SCHALI® (двуокись титана (TiO_2) SCHALI®-T/10-S).

Двуокись титана, альгинат кальция, диоктиладипинат, эластомер, карбоксиметилцеллюлоза натрия, 100% гидрогенизированный полимер, полиуретановая пленка.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии HMP SCHALI® обеспечивает достижение сбалансированного уровня серотонина в организме человека.

Синергический эффект взаимодействия гидроколлоидного минерального пластиря серии HMP SCHALI® способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов в организме человека. В момент соприкосновения изделия с кожей возникает тепловая реакция, в результате которой на поверхности насыщенных энергетическими реактогенными центрами кристаллов особого класса оксидов (TiO_2), являющихся полупроводниками,рабатываются активные молекулы кислорода [$O_2(a^1\Delta_g)$]. Проявление активности кислорода способствует возникновению энергии и, соответственно, переносу этой энергии на определенные участки тела. В результате этого запускается и поддерживается каскад биорезонансных волновых процессов. Это способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов, регулированию ингибирования обратного захвата серотонина путём избирательного блокирования всасывания серотонина мембраной пресинаптической клетки. Вследствие устранения дисбаланса нейромедиатора в синаптической щели усиливается нейротрансмиссия в серотонинергических синапсах.

Обеспечение сбалансированного уровня серотонина в организме оказывает выраженный положительный эффект на состояние здоровья человека и способствует устраниению симптомов различных патологических состояний, вызываемых электромагнитным излучением.

Генерируемое электромагнитное излучение различной интенсивности рассматривается в качестве факторов биотехногенного полевого воздействия, дестабилизирующего системы физиологической адаптации человека и вызывающего падение физиологического коридора показателей центральной нервной системы (ЦНС).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Нарушения артериального давления (артериальная гипертония или гипотония)
- Нарушение мозгового кровообращения, головокружения
- Головная боль напряжения
- Снижение работоспособности, внимания, способности концентрироваться
- Чувство хронической усталости, депрессия, физическая слабость, отсутствие жизненных сил
- Внутреннее психологическое напряжение (страх, фобии, синдромы дальнего перелета)
- Постоянное чувство раздраженности, подавленности
- Плохой, беспокойный сон
- Быстрая неадекватная смена настроения
- Повышенное болевое восприятие, боли в мышцах и мягких тканях
- Отышка, нарушения сердечного ритма
- Гипоксия, нарушение кислородного обмена организма

- Нарушение моторики и секреции желудочно-кишечного тракта
- Метеозависимость и нарушения, вызываемые сменой часовых поясов
- Восприимчивость к укачиванию.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:

Изделие может быть использовано в составе комплексной терапии, совместимо с лекарственными препаратами.

При использовании изделия коррекция дозировки назначенных лекарственных средств или их отмена производится лечащим врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Изделие следует наклеить на шею сзади в область 7-го (наиболее выступающего) шейного позвонка и на акупунктурные точки (см. Схему акупунктурных точек), а также на проблемные участки болевых ощущений или дискомфорта над внутренними органами и носить его непрерывно, не снимая даже в ночное время. Изделие устойчиво к воздействию воды и перепаду температур, может использоваться в среднем 3-7 дней. Появление чувства тепла в области воздействия изделия является нормальной реакцией и не требует прекращения использования. Первый эффект можно почувствовать - в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека - спустя 10-40 минут. Курс применения изделия определяется в каждом случае индивидуально

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Фиксирующая часть изделия состоит из полимерного экоблагоприятного материала прозрачного цвета с гипоаллергенным клеевым покрытием и входящей в гидроколлоидную основу активной минеральной композиции SCHALI®. Изделие с двух сторон покрыто защитными внутренними лепестками. Изделие стерильно и выпускается в индивидуальной контурной упаковке с контролем вскрытия.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Изделие следует хранить в неповрежденной контурной упаковке при температуре не выше +25°C, без соприкосновения с пахнущими и химическими веществами.

Не допускается ношение изделия в сауне и солярии.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

При приеме солнечных ванн изделие не использовать.



СРОК ГОДНОСТИ:

Срок годности изделия составляет 3 года с даты производства.

Не рекомендуется использовать изделие после срока годности, указанного на упаковке.

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии **HMP SCHALI®** производится по лицензии No. 286-S

Схема акупунктурных точек

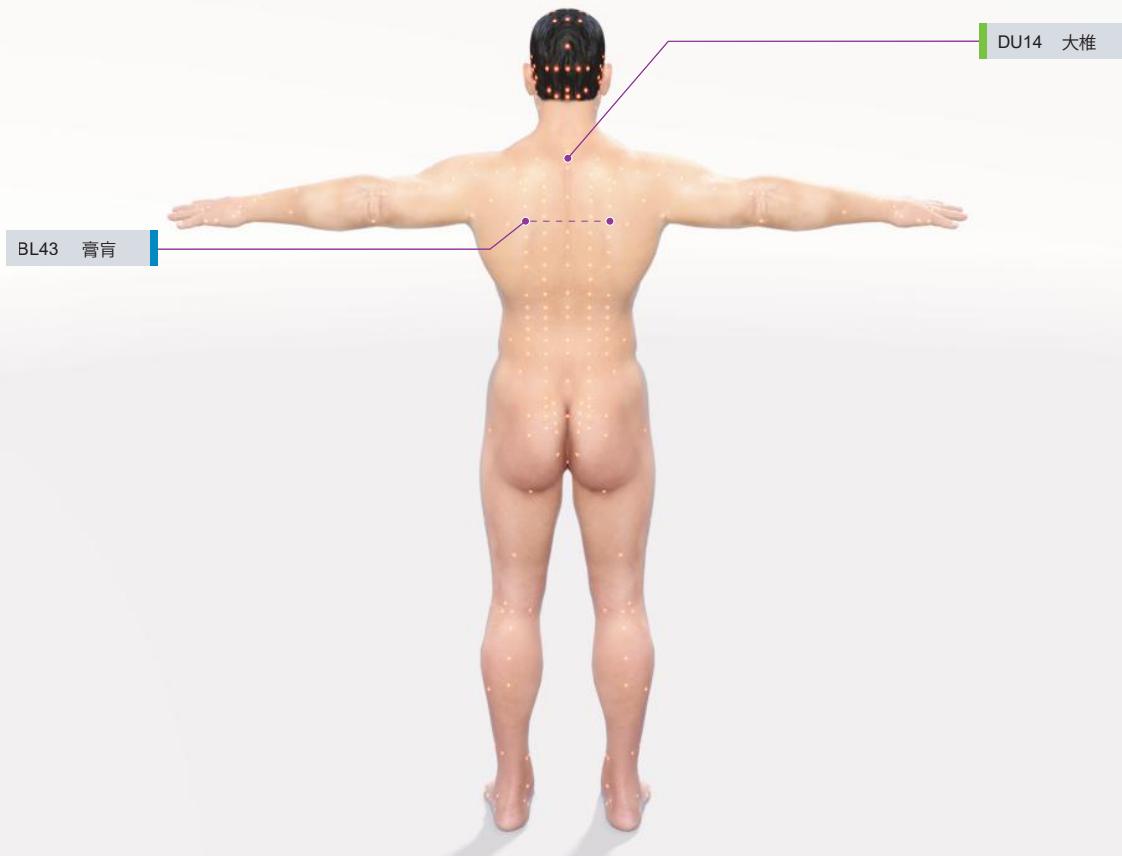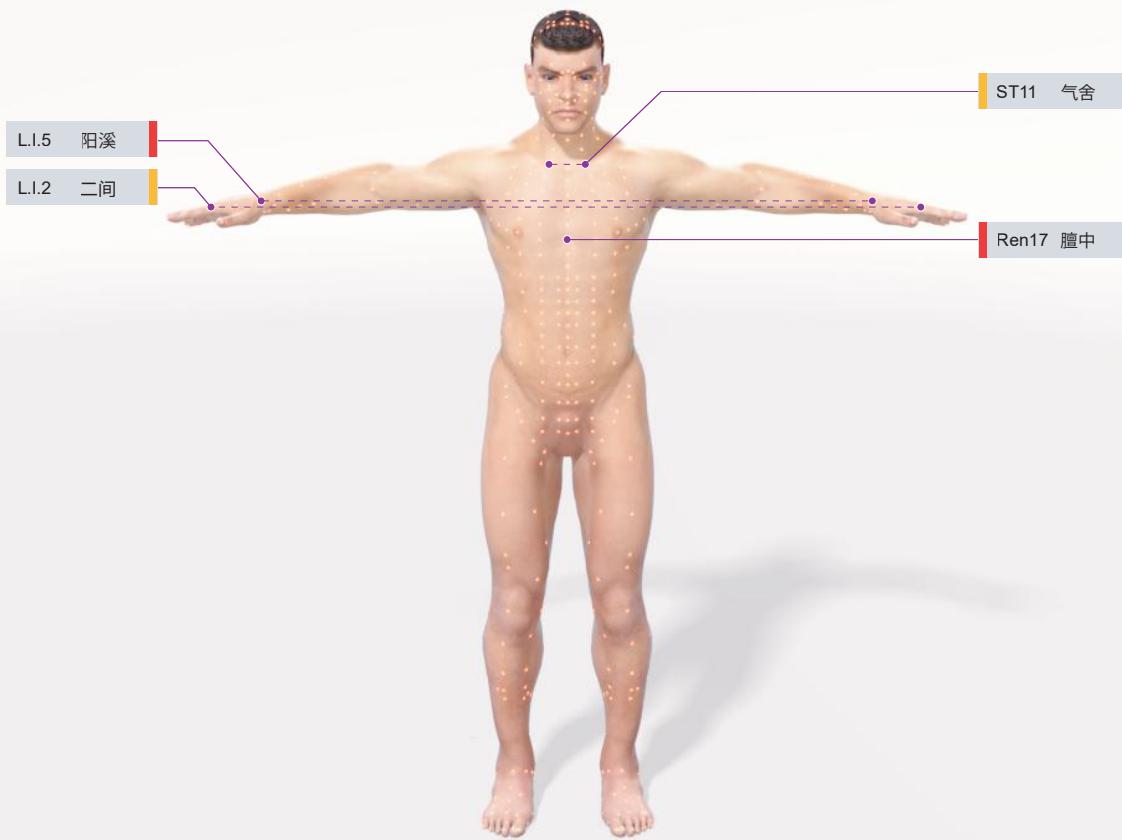

Методика акупунктурной терапии соответствует Стандартной Акупунктурной Номенклатуре (ВОЗ 1993 г.).



С более подробной информацией о методике акупунктурной терапии можете ознакомиться на сайте www.schalipharma.com



SCHALI PRODUCT
NO LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

Схема акупунктурных точек

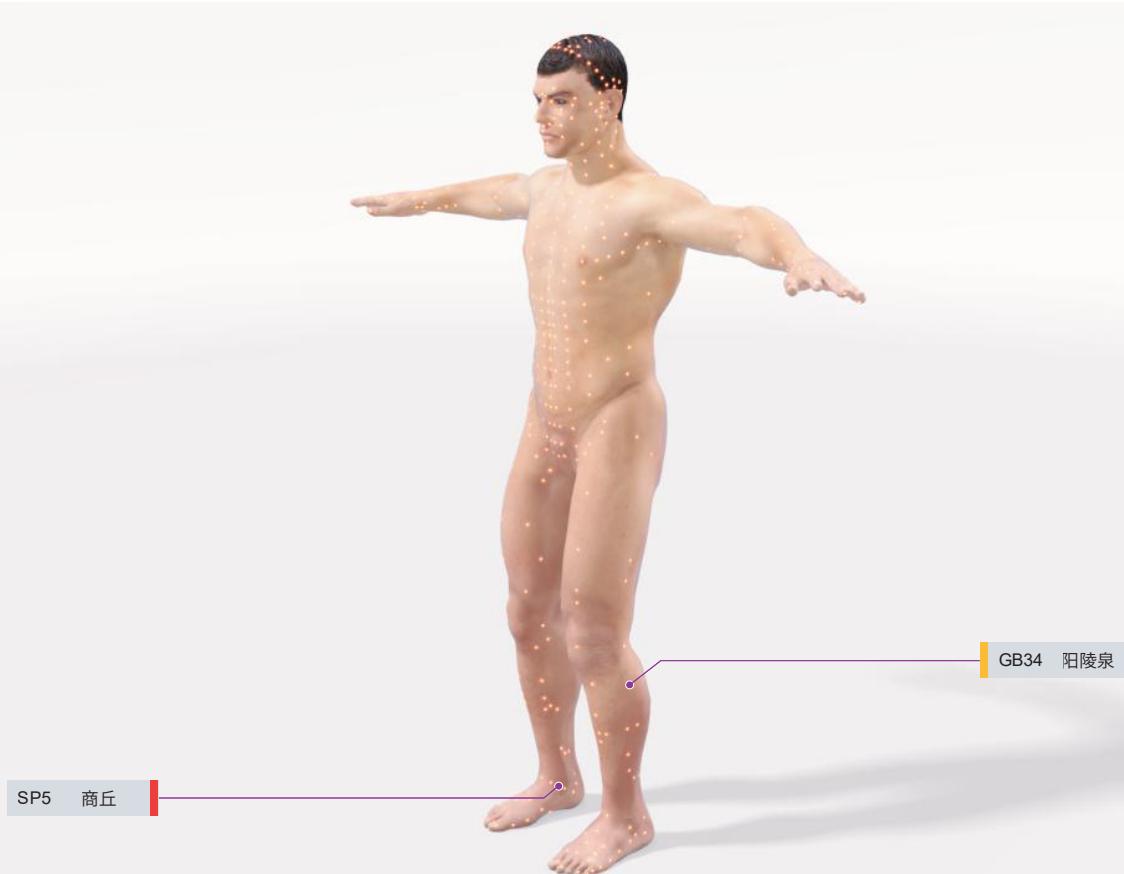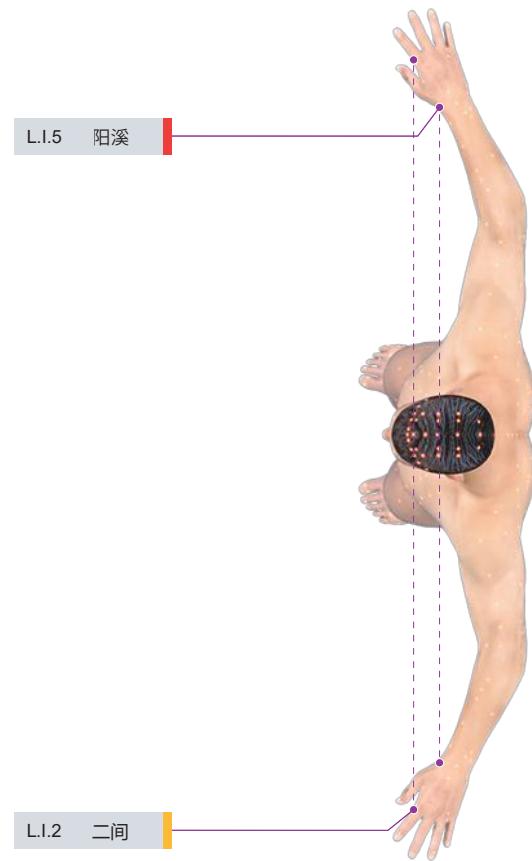

Методика акупунктурной терапии соответствует Стандартной Акупунктурной Номенклатуре (ВОЗ 1993 г.).

С более подробной информацией о методике акупунктурной терапии можете ознакомиться на сайте www.schalipharma.com



SCHALI PRODUCT
NO LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER