




**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению изделия**  
**нормализации серотонинового баланса организма**  
**Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластырь (НМР)**  
**“SCHALI® – Ушибы”**

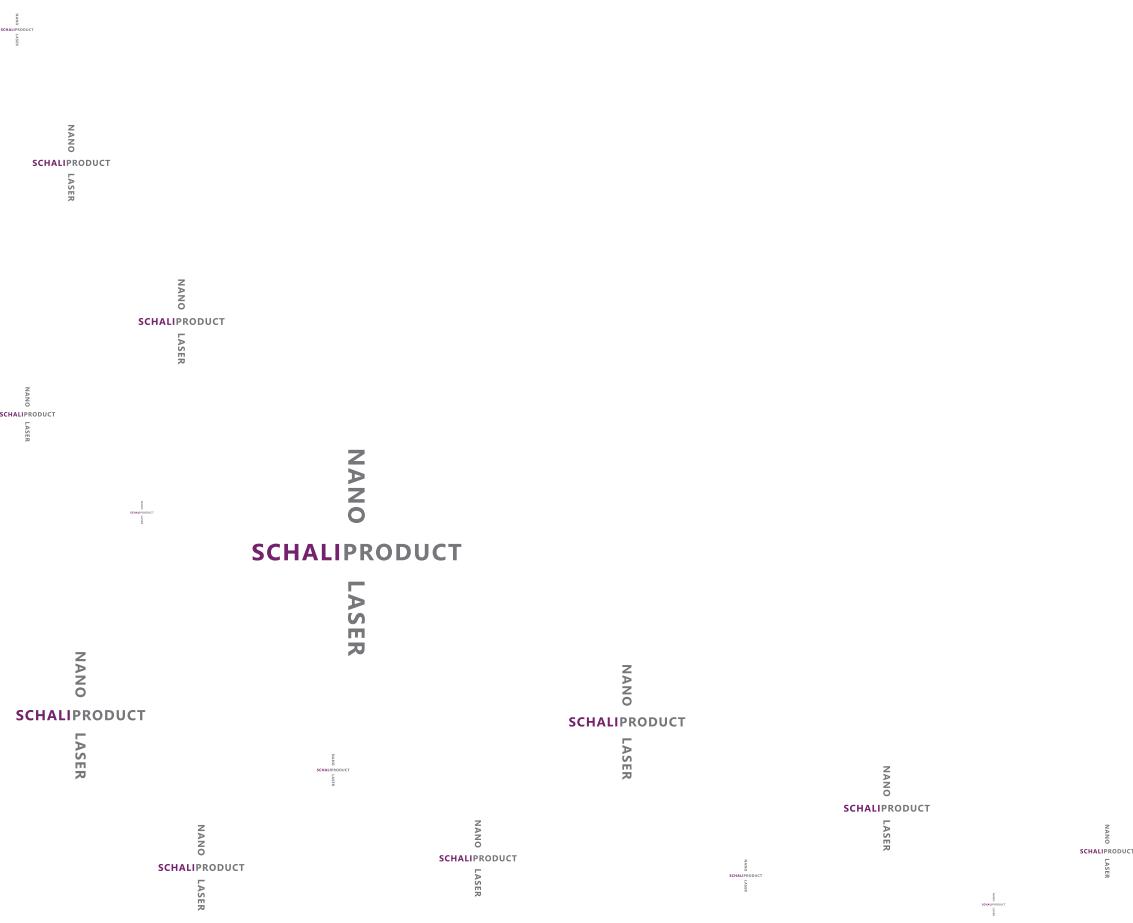

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению изделия**  
**нормализации серотонинового баланса организма**  
**Стерильный Гидроколлоидный Минеральный Пластирь (НМР)**  
**"SCHALI® – Ушибы"**

**СОСТАВ:**

**HMP SCHALI®-Ушибы** - гидроколлоидный минеральный пластырь на основе активной композиции SCHALI® (двуокись титана ( $TiO_2$ ) SCHALI®-T/10-S).

Двуокись титана, альгинат кальция, диоктиладипинат, эластомер, карбоксиметилцеллюлоза натрия, 100% гидрогенизированный полимер, полиуретановая пленка.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии HMP SCHALI® обеспечивает достижение сбалансированного уровня серотонина в организме человека.

Синергический эффект взаимодействия гидроколлоидного минерального пластиря серии HMP SCHALI® способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов в организме человека. В момент соприкосновения изделия с кожей возникает тепловая реакция, в результате которой на поверхности насыщенных энергетическими реактогенными центрами кристаллов особого класса оксидов ( $TiO_2$ ), являющихся полупроводниками,рабатываются активные молекулы кислорода [ $O_2(a^1\Delta_g)$ ]. Проявление активности кислорода способствует возникновению энергии и, соответственно, переносу этой энергии на определенные участки тела. В результате этого запускается и поддерживается каскад биорезонансных волновых процессов. Это способствует нормализации функционирования серотониновых рецепторов, регулированию ингибирования обратного захвата серотонина путём избирательного блокирования всасывания серотонина мембраной пресинаптической клетки. Вследствие устранения дисбаланса нейромедиатора в синаптической щели усиливается нейротрансмиссия в серотонинергических синапсах.

Обеспечение сбалансированного уровня серотонина в организме оказывает выраженный положительный эффект на состояние здоровья человека и способствует устраниению симптомов различных патологических состояний, восстановлению автоматизма и сократительной функции гладкой мускулатуры; агрегации тромбоцитов; подвижности нейтрофилов.

Здоровое функционирование серотониновых рецепторов в организме также помогает быстро восстановить гомеостаз, способствует общему оздоровлению и улучшению деятельности основных органов и систем организма.

Так, под действием серотонина нейроны спинного мозга секретируют энкефалин, который вызывает пресинаптическое торможение афферентных нервных волокон типа С и А, отвечающих за проведение болевой чувствительности. За счет восстановления нормального кровоснабжения и питания кислородом такней эффективно устраняются застойные явления и воспалительные процессы, мощно усиливается циркуляция крови и лимфы, происходит очищение от токсинов и шлаков, улучшаются обменные процессы.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:**

- Ушибы, отеки и травмы мягких тканей
- Заболевания и нарушения в околосуставных мягких тканях: тендинит, тендовагинит, тендобурсит, лигаментит, энтеозисные воспаления
- Боль в мягких тканях позвоночника при его дегенеративном заболевании (остеохондроз и другие проявления дорсопатии)
- Невралгии, связанные с заболеваниями периферических нервов

- Посттравматические боли
- После хирургического вмешательства для лучшего заживления послеоперационных ран
- Дисфункция гладкой мускулатуры микроциркуляторного русла.

Также использование изделия HMP SCHALI® рекомендуется здоровым, ведущим активный образ жизни (спорт, фитнес) людям для поддержания сбалансированного уровня серотонина в организме, в целях нормального функционирования нервной системы и организма в целом, а также для защиты организма от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:**

Изделие может быть использовано в составе комплексной терапии, совместимо с лекарственными препаратами.

При использовании изделия коррекция дозировки назначенных лекарственных средств или их отмена производится лечащим врачом.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Изделие следует наклеить на шею сзади в область 7-го (наиболее выступающего) шейного позвонка и на акупунктурные точки (см. Схему акупунктурных точек), а также на проблемные участки болевых ощущений или дискомфорта над внутренними органами и носить его непрерывно, не снимая даже в ночное время. Изделие устойчиво к воздействию воды и перепаду температур, может использоваться в среднем 3–7 дней. Появление чувства тепла в области воздействия изделия является нормальной реакцией и не требует прекращения использования. Первый эффект можно почувствовать – в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека – спустя 10–40 минут. Курс применения изделия определяется в каждом случае индивидуально.

### **ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:**

Побочных действий не выявлено.

Не развивается зависимость и не возникает синдром отмены.

### **ФОРМА ВЫПУСКА:**

Фиксирующая часть изделия состоит из полимерного экоблагоприятного материала прозрачного цвета с гипоаллергенным kleевым покрытием и входящей в гидроколлоидную основу активной минеральной композиции SCHALI®. Изделие с двух сторон покрыто защитными внутренними лепестками. Изделие стерильно и выпускается в индивидуальной контурной упаковке с контролем вскрытия.

### **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Изделие следует хранить в неповрежденной контурной упаковке при температуре не выше +25°C, без соприкосновения с пахнущими и химическими веществами.

Не допускается ношение изделия в сауне и солярии.

Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

При приеме солнечных ванн изделие не использовать.


### **СРОК ГОДНОСТИ:**

Срок годности изделия составляет 3 года с даты производства.


Не рекомендуется использовать изделие после срока годности, указанного на упаковке.

Гидроколлоидный минеральный пластырь серии **HMP SCHALI®** производится по лицензии No. 286-S

## Схема акупунктурных точек

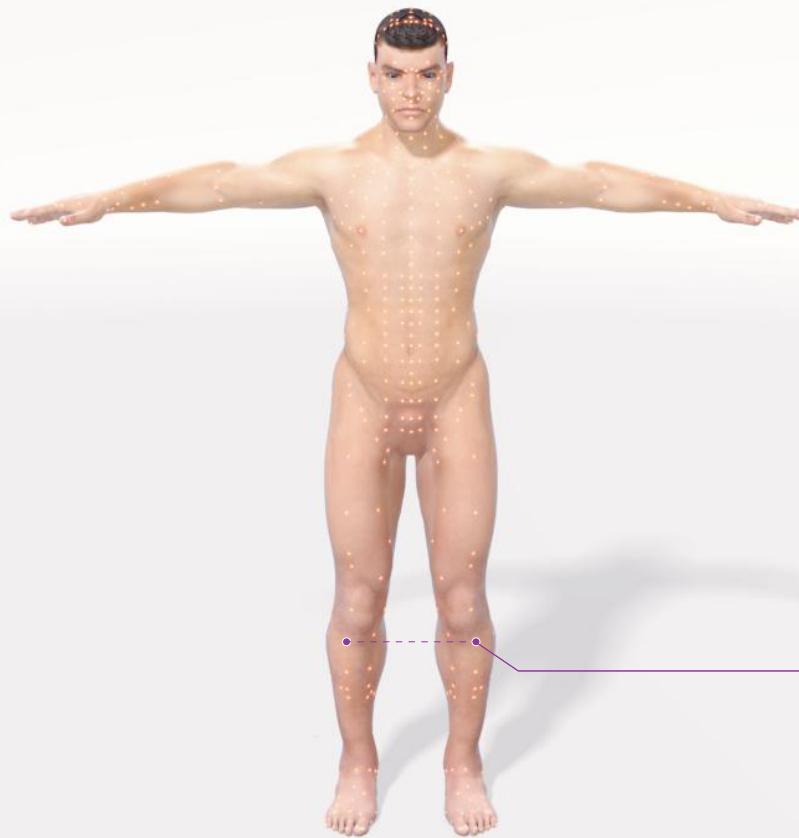

ST36 足三里

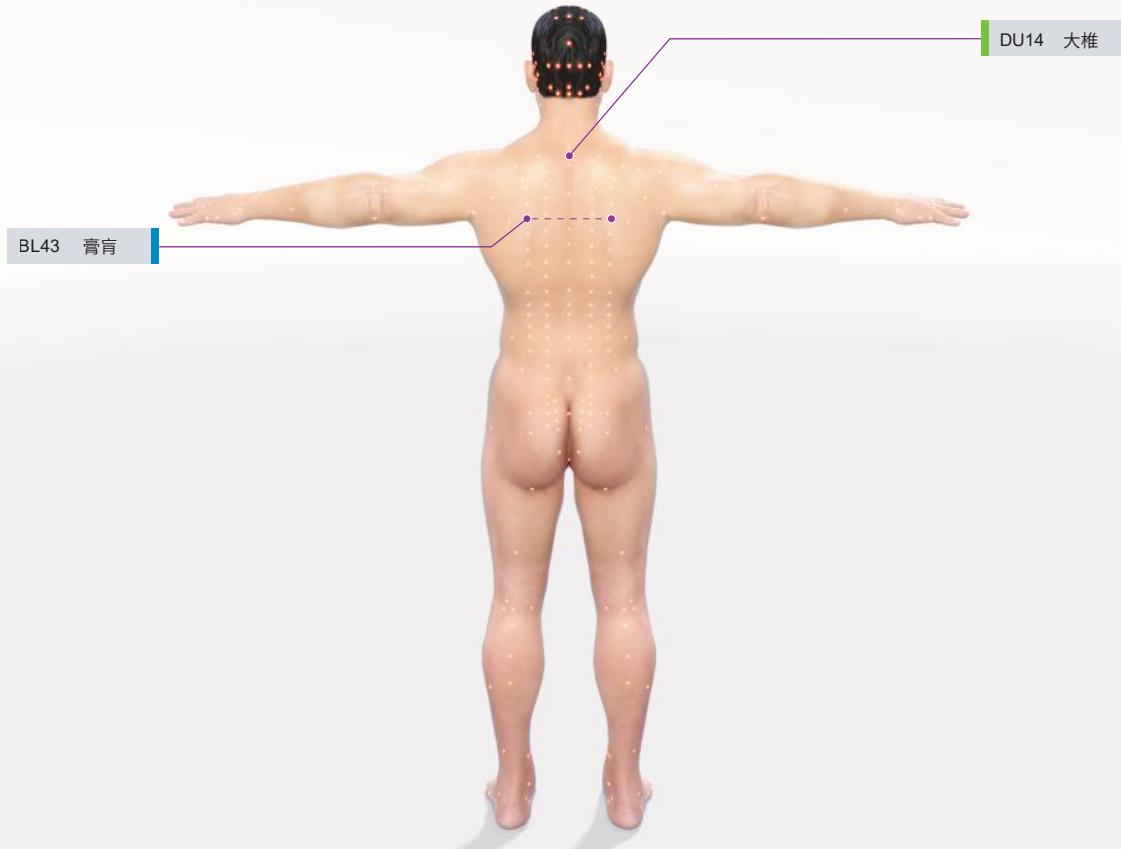

DU14 大椎

Методика акупунктурной терапии соответствует Стандартной Акупунктурной Номенклатуре (ВОЗ 1993 г.).

С более подробной информацией о методике акупунктурной терапии можете ознакомиться на сайте [www.schalipharma.com](http://www.schalipharma.com)



SCHALI  
PRODUCT  
NO  
LASER

NANO  
PRODUCT  
LAYER

NANO  
PRODUCT



NANO  
PRODUCT

NANO  
PRODUCT

NANO  
PRODUCT

NANO  
PRODUCT

## Схема акупунктурных точек

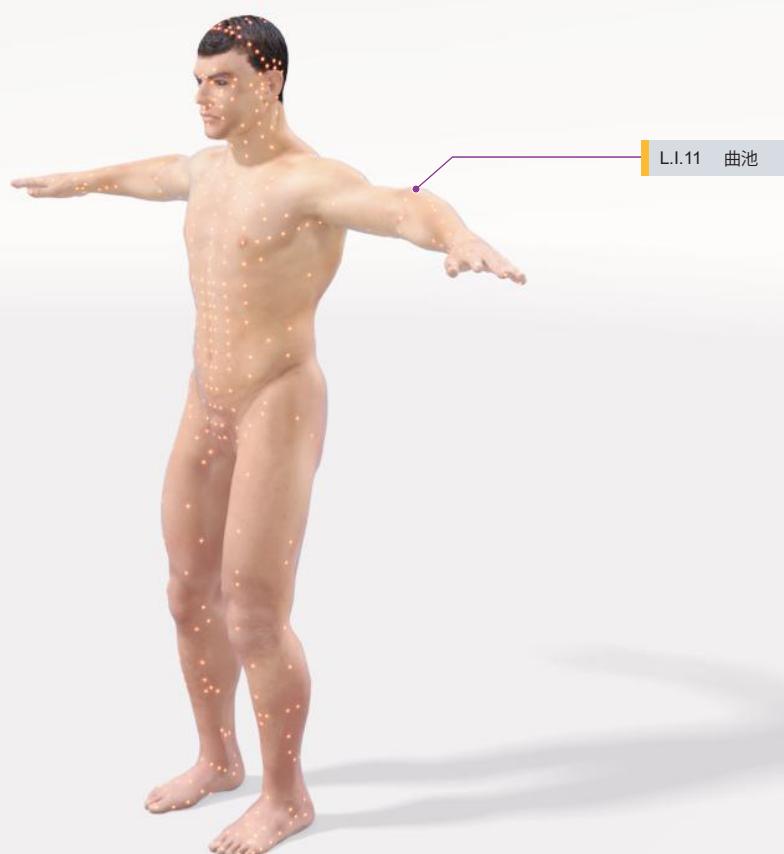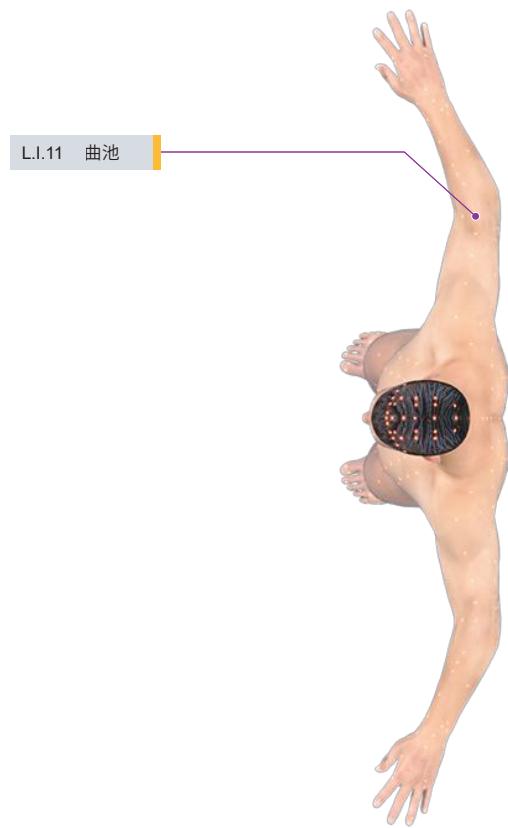

Методика акупунктурной терапии соответствует Стандартной Акупунктурной Номенклатуре (ВОЗ 1993 г.).

С более подробной информацией о методике акупунктурной терапии можете ознакомиться на сайте [www.schalipharma.com](http://www.schalipharma.com)

